
MD2071 快速扩增灵敏度评价

实验条件：

产品货号	MD2071	体系	ASFV 检测体系
模板	ASFV 质粒模板	模板浓度	3copies/T，24T
程序	50℃ 2min；95℃ 1min；50 Cycles（95℃ 1s，60℃ 5s）		
仪器	Q5		

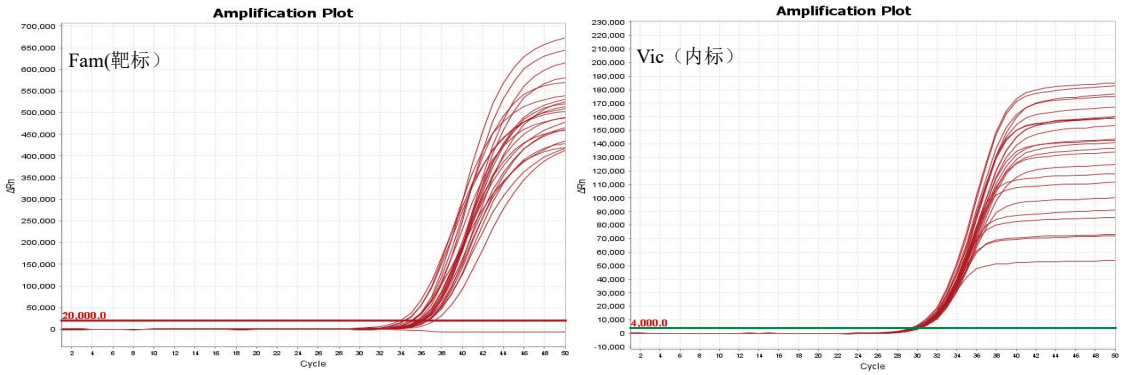



样本	ASFV 质粒模板，3copies/T			
靶标 Ct 值	37.72	34.47	34.86	36.16
	36.72	34.92	36.54	36.65
	36.48	35.62	NoCt	36.61
	36.41	36.97	35.42	37.13
	35.55	35.94	35.56	36.96
	36.14	36.10	36.96	36.36
均值	36.18			
方差	0.78			
Ct 值的 CV%	2.16%			
检出率	95.83%			


MD2071 快速扩增评价

实验条件：

产品货号	MD2071	体系	人基因组检测体系
模板	人基因组模板	模板浓度	0.125、0.0125、0.00125 ng/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 1min；50 Cycles（95℃ 1s，60℃ 5s）		
仪器	Q5		

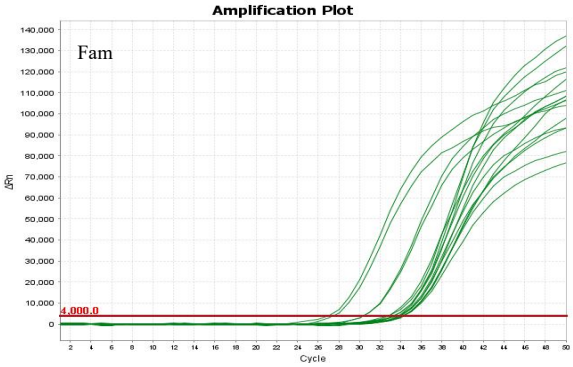

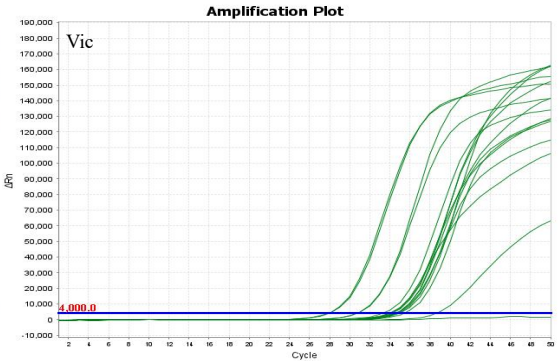

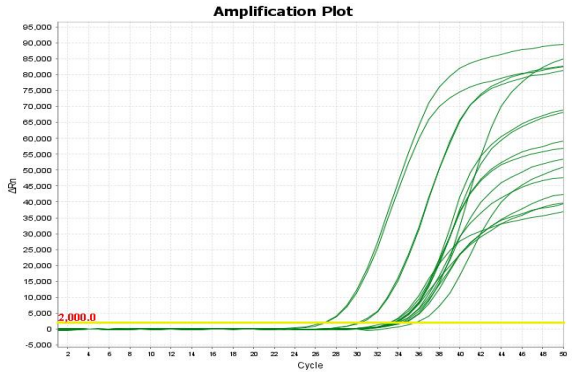

Cy5

MD2071 快速扩增评价

实验条件：

产品货号	MD2071	**体系**	HBV-MLN 纯模板检测体系
模板	HBV-MLN 纯模板	**模板浓度**	1E4 、1E3、50 IU/ml
程序	50℃ 2min；95℃ 1min；50 Cycles（95℃ 1s，60℃ 5s）		
仪器	Q5		

